


FX3180

透湿度試験機「カップマスター」

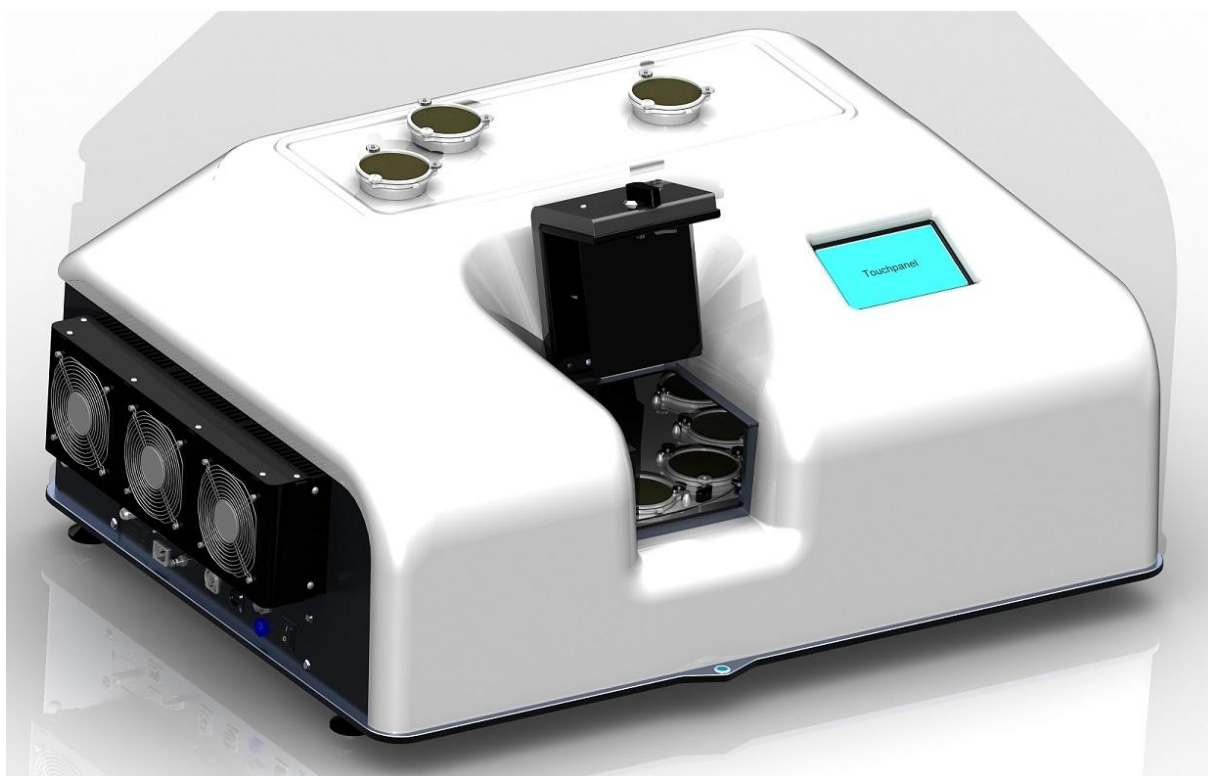

スイス・テクステスト社 日本総代理店

高山リード株式会社

〒920-0806 金沢市神宮寺 2-27-20

TEL:076-252-2266 FAX:076-252-3134

E-mail: info@takayamareed.co.jp

<基本仕様>

* 測定範囲:	50 cm ² 28.3 または 30 cm ²
* サンプル数:	50 cm ² の場合 12 カップ 28.3 または 30 cm ² の場合 15 カップ
* 秤のスケール:	0~220 g
* 秤の単位:	0.0001 g
* 温度設定:	-10°C~40°C
* 湿度設定:	23°Cの場合 40~90% r.h. 38°Cの場合 20~90% r.h.
* 風量設定:	0.1~2.5 m/s
* 測定精度:	温度 ±0.5°C 湿度 ±1.5% r.h.
* 寸法(w x d x h):	120 x 80 x 60 cm

<特長>

- * 自動終了機構を備え安全に使用できる。測定室を事前に温める事により結露の問題を解消。
- * 圧縮空気は本機内のターンテーブルの昇降にのみ使用し、測定室の環境を管理する目的には使用しません。よって圧縮空気の品質が測定結果に影響を与える事はありません。
- * 本機の設置場所での校正作業は必要ありません。温度・湿度・風量を測定するセンサーは取り外しが可能で、校正済みのセンサーに取り替えるだけで校正は終了します。
- * Mettler-Toledo 社の高精度質量センサーは校正時に簡単にアクセスできます。
- * 測定結果の評価や印刷以外にコンピューターは必要ありません。本機は LAN ケーブルや無線 LAN に対応しています。
- * 本機はタッチディスプレイ上で操作します。